





DE	Gebrauchsanweisung.....	5
GB	Instructions for use	9
FR	Mode d'emploi	13
ES	Instrucciones de uso	17
IT	Istruzioni per l'uso	21
PT	Instruções de uso	25
NL	Gebruiksaanwijzing	29
SE	Bruksanvisning	33
DK	Brugervejledning	37
NO	Bruksanvisning	41
FI	Käyttöohjeet	45
GR	Οδηγίες χρήσης	49
CZ	Návod k použití	53
HU	Használati utasítás	57
LV	Lietošanas instrukcija.....	61
LT	Naudojimo instrukcija	65
PL	Instrukcja obsługi	69
RU	Инструкция по применению	73

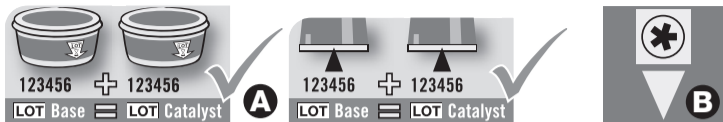


Description of applicational / packaging icons

- A** = Only use pastes with same LOT No
- B** = Icon "Use of the special program at the Dynamix® speed Mixing Unit possible"
- C** = Mixing ratio
- D** = Mixing time
- E** = Extraoral working time
- F** = Intraoral working time
- G** = Time in mouth
- H** = Static mixing tip
- K** = Intraoral tip



Cartridge Delivery System 2, 50 ml

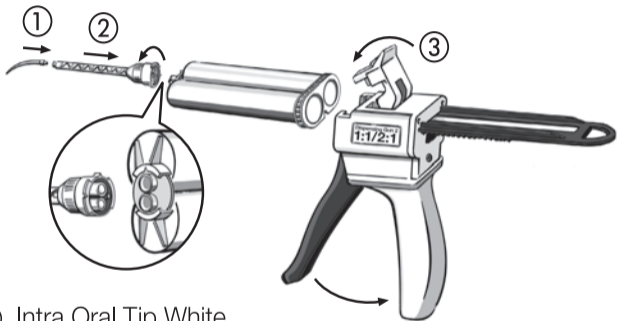

- ① Intra Oral Tip White
- ② Mixing Tip
- ③ Dispensing Gun 2

Elastomeres Präzisionsabformmaterial auf Silikonbasis, additionsvernetzend

Alle Produkte des Provil novo Sortimentes werden im Verhältnis 1 : 1 (Volumen oder Gewicht) dosiert.

Hinweise für den Gebrauch

Das Provil novo Sortiment ist ein ideal aufeinander abgestimmtes System und bietet Ihnen mit seinen Varianten die Möglichkeit für alle Abformtechniken individuell kombiniert zu werden. Von der Verwendung in Kombination mit anderen Silikonmaterialien raten wir ab. Bitte vor Erstgebrauch durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Produkte dürfen nicht eingesetzt werden. Nicht verschlucken und einnehmen. Treten nach Verschlucken von Abformmaterial gesundheitliche Beschwerden auf, umgehend Arzt aufsuchen. In seltenen Fällen kann z.B. Darmverschluss auftreten. Es sind keine Allergien nachgewiesen, dennoch können Allergien gegen das Produkt nicht ausgeschlossen werden. Anwendung nur durch zahnärztliches Fachpersonal.

Tube / Dosen nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Verschlüsse / Deckel / Dosierlöffel nicht vertauschen. Aus einer Kartusche vor Aufsetzen einer Mischkanüle etwas Material ausdrücken. Nach Gebrauch Mischkanüle als Verschluss auf der Kartusche belassen. Unmittelbar vor dem nächsten Gebrauch Mischkanüle entfernen, etwas Material ausdrücken und neue Mischkanüle aufsetzen.

Bei additionsvernetzenden Silikonabformmaterialien kann es bei Kontakt mit Latexhandschuhen, Retraktionslösungen oder frisch gelegten Kompositfüllungen zu Veränderungen im Abbindeverhalten kommen.

	EN ISO 4823	Produktfarbe		Mischzeit
		Base	Catalyst	s
Putty <i>fast set</i>	Typ 0 knetbar	grün	hellgrau	30
Putty <i>regular set</i>		grün		30
Putty soft <i>fast set</i>		türkis		30
Putty soft <i>regular set</i>		türkis		30
Monophase <i>Tube</i>	Typ 2 mittelfließend	blau	hellgrau	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blau		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		hellblau		–
Medium <i>Tube</i>		gelb	hellgrau	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		gelb		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		hellgelb		–
Light <i>Tube</i>	Typ 3 leichtfließend	dunkelgrün	hellgrau	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		dunkelgrün		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		grün		–

*bezogen auf Raumtemperatur von 23°C (73°F), 50% rel. Feuchte.
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Verarbeitungszeit extraoral* 23°C (73°F) min:s	Verarbeitungszeit intraoral 35°C (95°F) min:s	Mindestverweil- dauer im Mund min:s	Zubehör	
			Mixing Tips	Intraoral Tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	grün 66001989	weiß 65687514
2:00	1:00	3:30	grün 66001989	weiß 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gelb 66001988	gelb 66000782
2:00	1:00	3:30	gelb 66001988	gelb 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gelb 66001988	gelb 66000782
2:00	1:00	3:30	gelb 66001988	gelb 66000782

Nebenwirkungen:

Überempfindlichkeiten gegen das Produkt oder seine Bestandteile können im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden – Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen.

Modellherstellung:

Das Ausgießen der Abformung kann bereits 60 Minuten nach Herausnahme aus dem Mund erfolgen, keine weiteren Zeiteinschränkungen. Der Abdruck ist dauerhaft lagerstabil.

- Empfohlenes Modellmaterial:** Alle handelsüblichen Modellmaterialien sind einsetzbar.
Wir empfehlen: Klasse III Gips, z. B. MOLDANO®;
Klasse IV Gips, z. B. MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Galvanisierung:** Abformungen lassen sich galvanisch in üblichen Bädern verkupfern und versilbern.
- Desinfizierung:** Abformungen können mit einer wässrigen Natriumhypochloritlösung (5,25%igen, bis zu 10 Minuten*) oder mit anderen für Silikone geeigneten Desinfektionslösungen behandelt werden. Bitte beachten Sie dabei die Desinfektions-/Verarbeitungsvorschriften der jeweiligen Hersteller.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Haftvermittlung:** Wir empfehlen die Verwendung unseres Universal Adhesives.
- Lagerbedingungen:** Nicht über 25°C (77°F) lagern!

Stand: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Beschreibung der Anwendungs-/Packungssymbole

- | | |
|--|--|
| A = Nur Pasten mit gleicher LOT-Nr. verwenden | E = Verarbeitungszeit extraoral |
| B = Symbol „Verwendung des Spezialprogramms am Dynamix® speed-Mischgerät möglich“ | F = Verarbeitungszeit intraoral |
| C = Mischverhältnis | G = Verweildauer im Mund |
| D = Mischzeit | H = Statischer Mischer |
| | K = Intraoral Tip |

Elastomeric, silicone-based precision impression material, addition-cured

All products in the Provil *novo* assortment have a dosing ratio 1 : 1 (volume or weight).

Practical tips

Provil novo assortment is a variable consistency system that can be combined individually for all impression taking techniques. We do not recommend use in combination with any other silicone impression material. Visually inspect for damage before first use. Damaged products must not be used. Do not swallow and ingest. If health problems arise after swallowing impression material, seek medical attention immediately. Intestinal blockage may arise in rare cases. No allergic reactions have been demonstrated; however the product may still generate an allergic reaction. For use by dental personnel only.

Tubes and Tubs must be carefully sealed after use. Do not inter-change lids, caps or spoons. When using cartridges extrude some material before positioning mixing tip. After use leave used mixing tip in situ as sealer on cartridge. Before next use remove sealed tip. Extrude some material and then fix new mixing tip.

As is common with all addition cured silicone impression materials inhibiting reactions with catalyst paste can occur when in contact with latex gloves, retraction cords or solutions and newly placed composite fillings. Therefore, please ensure that patient's mouth (i.e. preparation and gingival margin) is thoroughly washed and dried before impression taking commences.

	EN ISO 4823	Product colour		Mixing time
		Base	Catalyst	s
Putty <i>fast set</i>	Type 0 putty	green	light grey	30
Putty <i>regular set</i>		green		30
Putty soft <i>fast set</i>		turquoise		30
Putty soft <i>regular set</i>		turquoise		30
Monophase <i>Tube</i>	Type 2 medium bodied	blue	light grey	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blue		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		light blue		–
Medium <i>Tube</i>	Type 2 medium bodied	yellow	light grey	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		yellow		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		light yellow		–
Light <i>Tube</i>	Type 3 light bodied	dark green	light grey	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		dark green		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		green		–

*at room temperature of 23°C (73°F), 50% rel. humidity.

Higher temperatures shorten, lower temperatures prolong these times.

Extraoral working time* 23°C (73°F) min:s	Intraoral working time 35°C (95°F) min:s	Min. time in mouth min:s	Accessories	
			Mixing Tips	Intraoral Tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	green 66001989	white 65687514
2:00	1:00	3:30	green 66001989	white 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	yellow 66001988	yellow 66000782
2:00	1:00	3:30	yellow 66001988	yellow 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	yellow 66001988	yellow 66000782
2:00	1:00	3:30	yellow 66001988	yellow 66000782

Side effects:

This product or one of its components may in particular cases cause hypersensitive reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.

Model fabrication:

The impression can be cast 60 minutes after removal from the mouth – there are no other time constraints. The impression is stable in long-term storage.

Recommended Model material:

All standard model materials can be used.
We recommend:
Class III Gypsum, e. g. MOLDANO®;
in the U.S.: Modern Materials®, Die Keen®;
Class IV Gypsum, e. g. MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Electroplating:

Impressions can be electroplated with copper or silver in conventional baths.

Disinfection:

Impressions can be treated with an aqueous sodium hypochlorite solution (5.25%, for up to 10 minutes*) or with other disinfectant solutions suitable for silicones. When doing so, please observe the disinfection/processing instructions issued by the relevant manufacturers.
* (DGZMK 3/93 V1.0)

Adhesion:

We recommend using our Universal Adhesive.

Storage conditions:

Do not store above 25°C (77°F).

Dated: 2014-03

Description of applicational/ packaging icons

A = Only use pastes with same LOT No
B = Icon "Use of the special program at the Dynamix® speed Mixing Unit possible"
C = Mixing ratio
D = Mixing time

E = Extraoral working time
F = Intraoral working time
G = Time in mouth
H = Static mixing tip
K = Intraoral tip

Matériau d'empreinte de précision élastomère à base de silicone, réticulant par addition

Tous les produits de la gamme Provil *novo* ont un rapport de dosage base/catalyseur = 1 pour 1 (en poids ou en volume).

Conseils pratiques :

La gamme Provil novo est un système complet et cohérent qui permet, grâce aux diverses combinaisons possibles, d'être utilisé pour toutes les techniques d'empreintes. Nous ne recommandons pas de combiner les produits de la gamme Provil novo avec d'autres matériaux silicones. Prière de bien vouloir vérifier avant la première utilisation que le produit n'est pas endommagé. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits endommagés. Ne pas avaler ni ingérer. Si des problèmes de santé apparaissent après l'ingestion de matériaux d'empreinte, consulter immédiatement un médecin. Une occlusion intestinale ou d'autres troubles peuvent survenir, même si cela est peu probable. Bien qu'aucune allergie n'ait été démontrée, on ne peut pas exclure une allergie au produit. Utilisation réservée au personnel dentaire compétent.

Les tubes doivent impérativement être bien refermés après chaque utilisation. Ne jamais interchanger les couvercles, les bouchons ou les cuillères. Lors de l'utilisation de cartouches, expulser un peu de produit avant de mettre l'embout mélangeur en place. Après utilisation laisser l'embout mélangeur en place, il agira comme un bouchon sur la cartouche. Immédiatement avant l'utilisation suivante: retirer l'embout usagé, expulser un peu de produit puis positionner le nouvel embout.

Tous les matériaux d'empreintes à base de silicone réticulant par addition peuvent présenter des temps de prise plus importants après contact avec des gants en latex, des solutions de rétraction ou des restaurations en composites fraîchement réalisées.

	EN ISO 4823	Couleur du produit		Temps de mélange s
		Base	Catalyseur	
Putty <i>fast set</i>	Typ 0 malléable	vert	gris clair	30
Putty <i>regular set</i>		vert		30
Putty soft <i>fast set</i>		turquoise		30
Putty soft <i>regular set</i>		turquoise		30
Monophase Tube	Typ 2 moyenne	bleu	gris clair	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		bleu		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		bleu clair		–
Medium Tube		jaunes	gris clair	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		jaunes		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		jaunes clair		–
Light Tube	Typ 3 forte	vert foncé	gris clair	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		vert foncé		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		vert		–

*à une température ambiante de 23°C (73°F) et une humidité relative de 50%.

Des températures supérieures réduisent ces durées, des températures inférieures les augmentent.

Temps de travail extra-oral* 23°C (73°F)	Temps de travail intra-oral 35°C (95°F)	Temps de passage en bouche minimum	Accessoires	
			Embouts mélangeurs	Embouts intra-oraux
min:s	min:s	min:s		
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	vert 66001989	blanc 65687514
2:00	1:00	3:30	vert 66001989	blanc 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	jaunes 66001988	jaunes 66000782
2:00	1:00	3:30	jaunes 66001988	jaunes 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	jaunes 66001988	jaunes 66000782
2:00	1:00	3:30	jaunes 66001988	jaunes 66000782

Effets secondaires:

Le produit ou l'un de ses composants peut dans des cas isolés provoquer des réactions allergiques. En cas de doute, la liste des ingrédients peut être obtenue auprès du fabricant.

Fabrication du modèle :

Le coulage de l'empreinte peut être effectué 60 minutes après son retrait de la bouche du patient. Aucune autre restriction de temps ne s'applique. L'empreinte reste stable et peut être conservée pendant une longue période.

Matériau recommandé pour réaliser le modèle :	Tous les matériaux destinés à la réalisation de modèles disponibles dans le commerce peuvent être utilisés. Nous recommandons : du plâtre de classe III, MOLDANO®; du plâtre de classe IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Galvanisation :	Les empreintes sont aptes à l'électrodéposition de cuivre ou d'argent à l'aide des bains galvaniques classiques.
Désinfection:	Les d'empreintes peuvent être traitées à l'aide d'une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium (solution à 5,25%, jusqu'à 10 minutes*) ou à l'aide d'autres solutions désinfectantes compatibles avec le silicone. Pour cela, veuillez respecter les prescriptions de chaque fabricant concernant la désinfection et la manipulation du produit. <small>* (DGZMK 3/93 V1.0)</small>
Adhésif pour porte-empreinte :	Nous recommandons l'utilisation de notre adhésif Universal Silicone Adhesive.
Conditions de stockage :	Conserver dans un endroit où la température ne dépasse pas 25°C (77°F) !

Mise à jour de l'information: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Description des symboles d'utilisation / d'emballage

A = Utiliser exclusivement des pâtes présentant le même n° de LOT

B = Symbole « Utilisation possible du programme spécial sur la machine de mélange Dynamix® *speed* »

C = Ratio de mélange

D = Temps de mélange

E = Temps de travail extra-oral

F = Temps de travail intra-oral

G = Temps (de prise) en bouche

H = Embout mélangeur statique

K = Embout intra-oral

Material elastomérico para impresiones de precisión con base de silicona, polimerizable por adición

Todos los componentes de Provil *novo* se aplican en proporción 1 : 1 (volumen o peso).

Utilizaciones de los tipos

Provil novo es un ideal sistema de sincronización, con esta variación creamos la posibilidad de combinaciones individuales para todas la técnicas de impresión. No recomendamos su uso en combinación con otras siliconas. Antes de la primera utilización, realizar una inspección visual para detectar posibles daños en el producto. No utilizar productos dañados. No ingerir ni tragar. En caso de que se produzcan molestias después de la ingestión de material de moldeado, solicitar atención médica. En ocasiones excepcionales puede producirse, por ejemplo, una obstrucción intestinal. No se ha probado que el producto provoque alergias, pero tampoco pueden excluirse. Uso exclusivo para personal especializado en odontología.

Los tubos deben ser cuidadosamente cerrados después de su uso. No intercambiar tapones o cucharas. Cuando se usen los cartuchos presionar suavemente hacia afuera algo de material que se encuentra en el cabezal de mezcla. Después del uso guardar el cartucho con el cabezal de mezcla puesta. Antes de usar quitar algo de material y poner un cabezal nuevo de mezcla.

Todos los materiales de impresión, siliconas de adicción, pueden sufrir cambios en el fraguado al estar en contacto con guantes de látex, soluciones de retracción; para que esto no ocurra aclararlo a fondo y secar para evitar problemas posteriores de fraguado en el material de impresión.

	EN ISO 4823	Color del producto		Tiempo de mezcla
		Base	Catalizador	s
Putty <i>fast set</i>	Tipo 0 maleable	verde	gris claro	30
Putty <i>regular set</i>		verde		30
Putty soft <i>fast set</i>		turquesa		30
Putty soft <i>regular set</i>		turquesa		30
Monophase <i>Tubo</i>	Tipo 2 semidenso	azul	gris claro	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		azul		-
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		azul claro		-
Medium <i>Tubo</i>		amarillo	gris claro	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		amarillo		-
Medium CD 2 <i>regular set</i>		amarillo claro		-
Light <i>Tubo</i>	Tipo 3 fluido	verde oscuro	gris claro	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		verde oscuro		-
Light CD 2 <i>regular set</i>		verde		-

*referidos a temperatura ambiente de 23°C (73°F) y a una humedad relativa de 50% temperatura más elevadas acortan estos tiempos y más bajas los prolongan.

Tiempo de trabajo fuera de la boca* 23°C (73°F) min:s	Tiempo de trabajo dentro de la boca 35°C (95°F) min:s	Mínimo tiempo en boca min:s	Accesorios	
			Mixing Tips	Intraoral Tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	verde 66001989	blanco 65687514
2:00	1:00	3:30	verde 66001989	blanco 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	amarillo 66001988	amarillo 66000782
2:00	1:00	3:30	amarillo 66001988	amarillo 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	amarillo 66001988	amarillo 66000782
2:00	1:00	3:30	amarillo 66001988	amarillo 66000782

Efectos secundarios:

Este producto o cualquiera de sus elementos pueden, en casos aislados, causar reacciones alérgicas. En caso de duda, puede solicitar información sobre los componentes al fabricante.

Elaboración de los modelos:

La impresión puede vaciarse ya a los 60 minutos tras sacarse de la boca, sin que existan otras limitaciones de tiempo. La impresión se conserva de forma duradera.

Material recomendado para los modelos:

Pueden utilizarse todos los materiales para modelos habituales en el mercado.

Recomendamos los siguientes:

Escayola de clase III, MOLDANO®;

Escayola de clase IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvanizado:

Las impresiones se pueden galvanizar con los sistemas habituales (con cobre o plata).

Desinfección:

Las impresiones pueden tratarse con una solución acuosa de hipoclorito sódico (al 5,25%, hasta 10 minutos*) u otras soluciones desinfectantes aptas para siliconas. Observe las normas de desinfección/utilización del fabricante correspondiente.

*(DGZMK 3/93 V1.0)

Agente de adhesión:

Recomendamos utilizar nuestro producto Universal Silicone Adhesive.

Condiciones de almacenamiento:

No almacenar a una temperatura mayor de 25°C (77°F).

Revisión: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Descripción de los símbolos de la aplicación/empaquetado

A = Use solo pastas con el mismo N.º de LOTE

E = Tiempo de trabajo fuera de la boca

B = Símbolo "Es posible el uso del programa especial mezclado en la Dynamix® *speed*"

F = Tiempo de trabajo dentro de la boca

C = Proporción de mezcla

G = Tiempo en la boca

D = Tiempo de mezcla

H = Punta de mezcla estática

K = Punta de mezcla intraoral

Materiale da impronta di precisione elastomerico a base di silicone per addizione

Tutto l'assortimento Provil *novo* viene dosato con un rapporto di miscelazione 1 : 1 (volume o peso).

Argomentazioni pratiche

L'assortimento di Provil novo viene incontro a tutte le esigenze tecniche di rilevamento d'impronta fornendo una gamma di prodotti che possono essere utilizzati individualmente in tutte le tecniche d'impronta. Se ne sconsiglia l'utilizzo in combinazione con altri materiali siliconici. Prima del primo utilizzo, effettuare un controllo visivo per escludere eventuali danni. Non utilizzare i prodotti se sono danneggiati. Non ingerire né inalare. Se, in seguito ad ingestione del materiale per impronta, si manifestano dei disturbi, consultare immediatamente un medico. In rari casi può verificarsi, ad esempio, un'occlusione intestinale. Non sono state dimostrate allergie, tuttavia non si escludono possibili allergie al prodotto. Uso riservato esclusivamente al personale odontoiatrico specializzato.

I tubetti devono essere chiusi accuratamente dopo l'uso. Non invertire i coperchi, i tappi o i cucchiari. Al momento dell'utilizzo della cartuccia far fuoriuscire un po' di prodotto prima di inserire il puntale di miscelazione. Dopo l'uso, utilizzare il puntale di miscelazione come tappo della cartuccia. Immediatamente prima del successivo utilizzo, far fuoriuscire un po' di prodotto ed inserire un nuovo puntale.

L'utilizzo di guanti di lattice, di soluzioni per retrazione gengivale o il contatto con restauri in composito di recente realizzazione con tutti i materiali siliconici da impronta a polimerizzazione per addizione, può provocare cambiamenti nella polimerizzazione.

	EN ISO 4823	Colore del materiale		Tempo di miscelazione s
		Base	Cataliz.	
Putty <i>fast set</i>	Tipo 0 plasmabile	verde	grigio chiaro	30
Putty <i>regular set</i>		verde		30
Putty soft <i>fast set</i>		turchese		30
Putty soft <i>regular set</i>		turchese		30
Monophase Tubo	Tipo 2 a consistenza media	blu	grigio chiaro	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blu		-
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		blu chiaro		-
Medium Tubo	Tipo 2 a consistenza media	giallo	grigio chiaro	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		giallo		-
Medium CD 2 <i>regular set</i>		giallo chiaro		-
Light Tubo	Tipo 3 a consistenza bassa	verde scuro	grigio chiaro	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		verde scuro		-
Light CD 2 <i>regular set</i>		verde		-

*Riferito a temperatura ambiente 23°C (73°F), 50% di umidità.

Temperature più elevate accorciano i tempi di lavorazione; temperature più basse allungano i tempi di lavorazione.

Tempo di lavorazione in sede extraorale* 23°C (73°F) min:s	Tempo di lavorazione in sede intraorale 35°C (95°F) min:s	Tempo min. di per- manenza in bocca min:s	Accessorios	
			Mixing Tips	Intraoral Tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	verde 66001989	bianco 65687514
2:00	1:00	3:30	verde 66001989	bianco 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	giallo 66001988	giallo 66000782
2:00	1:00	3:30	giallo 66001988	giallo 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	giallo 66001988	giallo 66000782
2:00	1:00	3:30	giallo 66001988	giallo 66000782

Effetti indesiderati:

Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sui componenti.

Realizzazione del modello:

La colata dell'impronta può avvenire già dopo 60 minuti dall'estrazione dalla bocca, senza altre limitazioni temporali. L'impronta presenta una stabilità permanente di conservazione.

- Materiale raccomandato per la realizzazione del modello:** Possono essere utilizzati tutti i comuni materiali per la realizzazione di modelli.
Consigliamo: Gesso di classe III, MOLDANO®;
Gesso di classe IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Galvanizzazione:** Le impronte possono essere sottoposte a ramatura e argentatura galvanica in comuni bagni.
- Disinfezione:** Le impronte possono essere trattate con una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio (al 5,25%, fino a 10 minuti*) oppure con altre soluzioni disinfettanti adeguate per siliconi. Si prega di rispettare le istruzioni per la disinfezione/lavorazione fornite dal rispettivo produttore.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Applicazione dell'adesivo:** Consigliamo di utilizzare il nostro Universal Silicone Adhesive.
- Condizioni di conservazione:** Non tenere a temperatura superiore a 25°C (77°F).

Aggiornamento al: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Descrizione delle icone relative all'applicazione / icone sulla confezione

- | | |
|---|--|
| A = Utilizzare esclusivamente paste con lo stesso numero di lotto | E = Tempo di lavorazione in sede extraorale |
| B = Icona "Possibile utilizzo del programma speciale nel miscelatore Dynamix® speed" | F = Tempo di lavorazione in sede intraorale |
| C = Rapporto di miscelazione | G = Permanenza nel cavo orale |
| D = Tempo di miscelazione | H = Puntale di miscelazione statico |
| | K = Puntale intraorale |

Material elastômero para moldagens precisas, à base de silicone

Todos os produtos da gama Provil novo são dosificados na proporção de 1 : 1 (volumétrica ou ponderal).

Informações para uso

A gama Provil novo é um sistema ideal de sincronização sucessiva, cujas variedades lhe permitem combinar, individualmente, todas as técnicas de impressão. Recomendamos que não se utilize em combinação com outros materiais de silicone. Antes da primeira utilização, submeter a uma inspecção visual, de forma a detectar possíveis danos. É proibido utilizar os produtos que apresentem danos. Não engolir nem ingerir. Caso ocorram problemas de saúde depois de se engolir material de moldagem, consulte imediatamente um médico. Em casos raros, pode ocorrer, por ex., oclusão intestinal. Embora não tenham sido comprovadas quaisquer reacções de hipersensibilidade, não se podem excluir reacções alérgicas ao produto. Aplicação apenas por pessoal médico especializado em odontologia.

Depois de usar, fechar as bisnagas / latas cuidadosamente. Não trocar as tampas nem as colheres de dosificação. Deixar sair um pouco do material antes de colocar a cânula de mistura no cartucho. Depois de usar, utilizar a cânula como tampa do cartucho. Antes de usar novamente, voltar a deixar sair um pouco do material e substituir a cânula por uma nova.

Todos os materiais de impressão à base de silicone ligados por adição ao entrarem em contacto com luvas de borracha, soluções de retracção, ou empastes compostos (de metal) ainda frescos podem apresentar alteração na liga.

	EN ISO 4823	Cor do produto		Tempo de mistura
		Base	Catalisador	s
Putty <i>fast set</i>	Tipo 0 moldável	verde	cinza claro	30
Putty <i>regular set</i>		verde		30
Putty soft <i>fast set</i>		turquesa		30
Putty soft <i>regular set</i>		turquesa		30
Monophase <i>Tube</i>	Tipo 2 consistência média	azul	cinza claro	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		azul		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		azul claro		–
Medium <i>Tube</i>	consistência média	amarelo	cinza claro	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		amarelo		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		amarelo claro		–
Light <i>Tube</i>	Tipo 3 consistência leve	verde escuro	cinza claro	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		verde escuro		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		verde		–

*relacionado com uma temperatura ambiente de 23°C (73°F), 50% de umidade relativa. Temperaturas mais elevadas reduzem os períodos indicados e temperaturas mais baixas prolongam-nos.

Tempo de trabalho extraoral* 23°C (73°F) min:s	Tempo de trabalho intraoral 35°C (95°F) min:s	Tempo mínimo intra-oral min:s	Acessórios	
			Pontas misturadoras	Pontas intra-orais
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	verde 66001989	branco 65687514
2:00	1:00	3:30	verde 66001989	branco 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	amarelo 66001988	amarelo 66000782
2:00	1:00	3:30	amarelo 66001988	amarelo 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	amarelo 66001988	amarelo 66000782
2:00	1:00	3:30	amarelo 66001988	amarelo 66000782

Efeitos colaterais:

Este produto ou algum de seus componentes pode provocar reações alérgicas em casos isolados. Em caso de suspeita, contate o fabricante para obter informações sobre a composição.

Confecção do modelo:

O molde pode ser vazado a partir de 60 min após a remoção da boca, sem outras limitações de tempo. O molde apresenta uma estabilidade permanente ao armazenamento.

Material recomendado para confecção do molelo:	Todos os materiais para confecção de modelo, disponíveis no mercado, podem ser utilizados. Recomendamos: Gesso de classe III, MOLDANO®; Gesso de classe IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Galvanização:	Os moldes podem ser cobreados ou prateados galvanicamente em banhos normais.
Desinfecção:	Os moldes podem ser tratados com uma solução aquosa de hipoclorito de sódio (a 5,25%, até 10 minutos*) ou com outras soluções de desinfecção adequadas para silicone. Observe as indicações de desinfecção/processamento do respectivo fabricante. * (DGZMK 3/93 V1.0)
Adesivo:	Recomendamos a utilização do nosso adesivo universal para silicone.
Condições de armazenamento:	Não armazenar a temperaturas superiores a 25°C (77°F).

Última revisão: 2014-03

Description of applicational/ packaging icons

Descrição dos ícones de aplicação e da embalagem

A = Utilize apenas pastas com o mesmo n° de lote	E = Tempo de trabalho extraoral
B = Ícone indicando que o programa especial da Unidade de Mistura Dynamix® <i>speed</i> pode ser utilizado	F = Tempo de trabalho intraoral
C = Proporção da mistura	G = Tempo na boca
D = Tempo de mistura	H = Ponteira de mistura estática
	K = Ponteira intraoral

Elastomeer precisieafdrukmetaal op additiessiliconenbasis

Alle producten van het Provil *novo* assortiment worden 1 : 1 (Volume of gewicht) gedoseerd.

Aanwijzingen voor gebruik

Het Provil novo assortiment is een ideaal op elkaar afgestemd systeem. De vele varianten kunnen individueel worden gecombineerd voor alle afdruktechnieken. Wij raden u aan Provil novo niet met andere siliconenmaterialen te combineren. Voor eerste gebruik visueel op beschadigingen controleren. Beschadigde producten mogen niet worden gebruikt. Niet inslikken of innemen. Indien na het inslikken van afdrukmetaal gezondheidsklachten optreden, waarschuw dan direct een arts. In zeldzame gevallen kan darmverstopping optreden. Er zijn geen allergieën aangetoond, desondanks kunnen allergische reacties op het product niet uitgesloten worden. Toepassing alleen door opgeleid tandartspersoneel.

Na gebruik moeten de tubes / potten zorgvuldig worden gesloten. Wissel geen deksels, doppen of lepels. Bij cartridges bevelen wij aan om voor het plaatsen van de mengtip eerst wat metaal uit de cartridge de drukken. Laat na gebruik de mengtip op de cartridge als sluiting. Net voor het volgende gebruik eerst wat metaal uitdrukken en dan een nieuwe mengtip plaatsen.

De uitharding van alle additie-siliconen kan worden beïnvloed door contact met latex handschoenen, retractie vloeistoffen, eugenol houdende producten en pas gelegde composietvullingen.

	EN ISO 4823	Productkleur		Mengtijd s
		Basis	Katalysator	
Putty <i>fast set</i>	Type 0 kneedbaar	groen	lichtgrijs	30
Putty <i>regular set</i>		groen		30
Putty soft <i>fast set</i>		turkoois		30
Putty soft <i>regular set</i>		turkoois		30
Monophase <i>Tube</i>	Type 2 gemiddeld vloeibaar	blauw	lichtgrijs	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blauw		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		lichtblauw		–
Medium <i>Tube</i>		geel	lichtgrijs	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		geel		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		lichtgeel		–
Light <i>Tube</i>	Type 3 dunvloeibaar	donkergroen	lichtgrijs	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		donkergroen		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		groen		–

*op basis van kamertemperatuur 23°C (73°F), 50% relatieve vochtigheid.

Bij hogere temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere temperaturen langzamer.

Extraorale verwerkingstijd* 23°C (73°F) min:s	Intraorale verwerkingstijd 35°C (95°F) min:s	Minimal verblijfs- duur in de mond min:s	Toebehoren	
			Mengtips	Intraorale tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	groen 66001989	wit 65687514
2:00	1:00	3:30	groen 66001989	wit 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	geel 66001988	geel 66000782
2:00	1:00	3:30	geel 66001988	geel 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	geel 66001988	geel 66000782
2:00	1:00	3:30	geel 66001988	geel 66000782

Bijwerkingen:

Dit product of de bestanddelen ervan kunnen in bepaalde gevallen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Als een dergelijke reactie vermoed wordt, kan informatie over de ingrediënten worden verkregen bij de fabrikant.

Vervaardiging van het model:

Het uitgieten van de afdruk kan reeds 60 min. na verwijdering uit de mond plaatsvinden; er zijn geen verdere tijdsbeperingen. De afdruk is stabiel in langdurige opslag.

- Aanbevolen modelmateriaal:** Alle normaal in de handel verkrijgbare modelmaterialen kunnen worden gebruikt.
Wij raden aan: Klasse III gips, MOLDANO®;
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Galvanisering:** Afdrukken kunnen galvanisch in de gebruikelijke baden worden verkoperd en verzilverd.
- Desinfectie:** Afdrukken kunnen met een waterige natriumhypochlorietoplossing (5,25%, max.10 minuten*) of met andere voor siliconen geschikte desinfectiemiddelen worden behandeld. Neem daarbij de desinfectie-/verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikanten in acht.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Adhesie:** Wij raden het gebruik van onze Universal Silicone Adhesives aan.
- Bewaren:** Niet bewaren boven 25°C (77°F).

Status: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Beschrijving van toepassings- en verpakkingspictogrammen

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A = Gebruik alleen pasta's met hetzelfde LOT-nummer | E = Extraorale verwerkingstijd |
| B = Pictogram 'Gebruik van het speciale programma van het Dynamix® speed –mengapparaat mogelijk' | F = Intraorale verwerkingstijd |
| C = Mengverhouding | G = Intraorale uithardingstijd |
| D = Mengtijd | H = Statische mengtip |
| | K = Intraorale tip |

Elastomer precisionsavtrycksmaterial på silikonbas, additivt härdande

Hela Provil sortiment doseras 1 : 1 (Volym eller vikt).

Praktiska tips

Provil novo produktsortiment, en optimal sammansättning av konsistenser, möjliggör kombinationer för all tänkbar avtryckstagnung. Vi rekommenderar dock inte att materialet blandas med andra silikonmaterial. Kontrollera att produkten inte är skadad innan den används första gången. Skadade produkter får inte användas. Får inte förtäras. Den som råkar svälja avgjutningsmaterial och upplever hälso- besvär ska omedelbart uppsöka läkare. I sällsynta fall kan exempelvis tarmvred uppstå. Inga allergier har påvisats, men allergier mot produkten kan ändå inte uteslutas. Får endast användas av tandvårdspersonal.

Tuberna måste förslutas noggrant efter användandet. Blanda inte ihop korkar, lock eller måttskedar. När CD ampuller används, tryck ur lite material ur ampullen innan blandningsspetsen appliceras. Låt blandningsspetsen sitta kvar som förslutning efter användandet. Före nästa gång ampullen användes, tag bort den gamla blandningsspetsen, tryck ut lite material, applicera ny blandningsspets.

Undvik kontakt med latexhandskar, retraktionsvätskor och nygjorda kompositfyllningar, då dessa kan ha en negativ inverkan på A-silikonets stelningsförfarande.

	EN ISO 4823	Produktfärg		Blandningstid s
		Bas	Katalysator	
Putty <i>fast set</i>	Typ 0 knådbar	grön	ljusgrå	30
Putty <i>regular set</i>		grön		30
Putty soft <i>fast set</i>		turkos		30
Putty soft <i>regular set</i>		turkos		30
Monophase <i>Tub</i>	Typ 2 mellantrög- flytande	blå	ljusgrå	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blå		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		ljusblå		–
Medium <i>Tub</i>		gul	ljusgrå	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		gul		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		ljusgul		–
Light <i>Tub</i>	Typ 3 lättflytande	mörkgrön	ljusgrå	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		mörkgrön		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		grön		–

*gäller vid rumstemperatur 23°C (73°F), 50% relativ luftfuktighet.

Högre temperatur ger kortare stelningstid och lägre temperatur ger längre stelningstid.

Extraoral arbetstid* 23°C (73°F) min:s	Intraoral arbetstid 35°C (95°F) min:s	Minimum tid i munnen min:s	Tillbehör	
			Blandningsspetsar	Intraorala spetsar
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	grön 66001989	vit 65687514
2:00	1:00	3:30	grön 66001989	vit 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gul 66001988	gul 66000782
2:00	1:00	3:30	gul 66001988	gul 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gul 66001988	gul 66000782
2:00	1:00	3:30	gul 66001988	gul 66000782

Biverkningar:

Produkten eller någon av dess ingredienser kan i specifi ka fall orsaka överkänsliga allergiska reaktioner. Om du misstänker allergisk överkänslighet kan du kontakta tillverkaren för att få information om innehållet.

Modellframställning:

Avtrycket kan slås ut redan 60 minuter efter det tagits ut ur munnen. Inga ytterligare tidsrestriktioner finns. Avtrycket är stabilt vid förvaring.

**Rekommenderat
modellmaterial:**

Alla på marknaden tillgängliga modellmaterial kan användas.

Vi rekommenderar:

Klass III-gips, MOLDANO®;

Klass IV-gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvanisering:

Avtrycken kan galvaniseras med koppar eller silver i vanliga bad.

Desinficering:

Avtryck kan behandlas med en vattenbaserad natriumhypokloritlösning (5,25 %, upp till 10 minuter*) eller med andra desinfektionslösningar för silikon. Beakta desinfektions-/bearbetningsanvisningarna från respektive tillverkare.

* (DGZMK 3/93 V1.0)

Adhesion:

Vi rekommenderar användning av våra Universal Silicone Adhesives.

Förvaring:

Bör inte lagras i temperaturer överstigande 25°C (77°F).

Version: 2014-03

Description of applicational/packaging icons

Beskrivning av tillämpliga ikoner/förpackningsikoner

A = Använd endast pastor med samma lotnummer

E = Extraoral arbetstid

B = Ikonen "Specialprogrammet kan användas på
Dynamix® speed blandningsenhet"

F = Intraoral arbetstid

C = Blandningsförhållande

G = Tid i munnen

D = Blandningstid

H = Blandningsspets

K = Intraoral spets

Elastomert præcisions-aftryksmateriale på siliconebasis, additionspolymeriserende

Alle Provil novo produkter doseres i forholdet 1 : 1 (volumen eller ægt).

Praktiske henvisninger

Provil novo sortimentet er et nøje, på hinanden afstemt system, og tilbyder dig, med dets varianter, muligheden for at kombinere alle aftryksteknikker. Anvendelse af andre silikonematerialer i kombination med Provil frarådes. Produktet skal kontrolleres visuelt for beskadigelser, før det bruges første gang. Hvis produktet er beskadiget, må det ikke tages i brug. Må ikke indtages. Hvis der opstår sundhedsmæssige problemer efter indtagning af aftryksmateriale, skal der straks søges læge. I sjældne tilfælde kan der f.eks. opstå tarmslyng. Der er ingen påviste allergier mod produktet, men de kan ikke udelukkes. Må kun bruges af tandlægeligt fagpersonale.

Efter brug lukkes tuber / dåser omhuggeligt. Skruelåg / låg / doseringsskeer må ikke forbyttes. Inden påsætning af en blandingsspiral trykkes lidt materiale ud af patronen. Efter brug efter lades blandingsspiralen som lukkemekanisme på patronen. Umiddelbart inden næste inbrugtagning trykkes lidt materiale ud og blandingsspiralen skiftes.

Hos alle additionsafbindende silikoneraftryksmaterialer kan der, ved kontakt med latexhandsker, gennem retraktionsopløsningsmidler eller gennem nyligt anlagte kompositfyldninger opstå afbindingsforandrende forstyrrelser.

	EN ISO 4823	Produktfarve		Blande tid
		Base	Katalysator	s
Putty <i>fast set</i>	Type 0 kan æltes	grøn	lysegrå	30
Putty <i>regular set</i>		grøn		30
Putty soft <i>fast set</i>		turkis		30
Putty soft <i>regular set</i>		turkis		30
Monophase <i>Tube</i>	Type 2 medium bodied	blå	lysegrå	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blå		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		lyseblå		–
Medium <i>Tube</i>		gul	lysegrå	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		gul		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		lysegul		–
Light <i>Tube</i>	Type 3 light bodied	mørkegrøn	lysegrå	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		mørkegrøn		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		grøn		–

*afhængig af stuetemperatur på 23°C (73°F), 50% rel. fugtighed.
Højere temperaturer forkorter, lavere forlænger disse tider.

Extraoral arbejdstid* 23°C (73°F) min:s	Intraoral arbejdstid 35°C (95°F) min:s	Minimum tid i munden min:s	Tilbehør	
			Blandespidts	Intraoral Tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	grøn 66001989	hvid 65687514
2:00	1:00	3:30	grøn 66001989	hvid 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gul 66001988	gul 66000782
2:00	1:00	3:30	gul 66001988	gul 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gul 66001988	gul 66000782
2:00	1:00	3:30	gul 66001988	gul 66000782

Bivirkninger:

Dette produkt eller en af dets komponenter kan i særlige tilfælde forårsage allergiske reaktioner. I tvivlstilfælde kan der indhentes oplysninger fra producenten om indholdsstofferne.

Modelfremstilling:

Udstøbning af aftrykket kan allerede finde sted 60 minutter, efter at det er taget ud af munden. Ingen yderligere tidsmæssige restriktioner. Aftrykket er stabilt under opbevaring.

- Anbefalet modelmateriale:** Alle i handlen værende modelmaterialer kan anvendes.
Vi anbefaler: Klasse III gips, MOLDANO®;
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Galvanisering:** Aftrykkene lader sig galvanisk forkobre og forsøve i gængse bade.
- Desinfektion:** Aftrykkene kan behandles med en vandig natriumhypochloritopløsning (5,25%, i indtil 10 minutter*) eller med andre desinfektionsopløsninger, der er egnet til silicone. I denne forbindelse bedes De være opmærksom på den pågældende producents forskrifter vedrørende desinfektion/bearbejdning.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Adhæsiver:** Vi anbefaler anvendelsen af vore Universal Silicone Adhesives.
- Opbevaringsbetingelser:** Opbevares ikke over 25°C (77°F).

Ajourført: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Beskrivelse af anvendelses / emballerings-symboler

- | | |
|--|---------------------------------|
| A = Anvend kun pastaer med samme LOT-nr | E = Extraoral arbejdstid |
| B = Symbol for: "Mulighed for anvendelse af det specielle program på Dynamix® Speed blandemaskinen" | F = Intraoral arbejdstid |
| C = Blandeforhold | G = Tid i munden |
| D = Blandetid | H = Blandespids |
| | K = Intraoral spids |

Elastomert presisjonsavtrykksmateriale på silikonbasis, som herdes ved addisjon

Alle produkter i Provil *novo* sortiment doseres i forholdet 1 : 1 (volumen eller vekt).

Praktiske tips

Provil novo sortimentet er et ideelt suksessivt tilpasset system som med sine varianter muliggjør individuelle kombinasjoner for alle avtrykksteknikker. Vi fraråder bruk i kombinasjon med andre silikonmaterialer. Kontroller visuelt om det er skader før førstegangsbruk. Produkter som er skadet, må ikke benyttes. Må verken svelges eller inntas. Hvis det oppstår helsemessige plager etter svelging av avformingsmateriale, oppsøk lege omgående. I sjeldne tilfeller kan det f.eks. oppstå tarmslyng. Det er ikke påvist allergier, likevel kan allergier mot produktet ikke utelukkes. Skal kun anvendes av tannhelsepersonell.

Tube må lukkes helt etter bruk. Bytt ikke om lokk, skrukorker eller skjeer. Ved bruk av ampuller, press ut litt materiale før montering av blandespissen. Behold blandespissen på ampullene som kork etter bruk. Press ut litt materiale umiddelbart før neste gangs bruk og monter en ny blandespiss.

Ved alle a-silikon baserte avtrykksmaterialer kan kontakt med latexhansker, retraksjonsløsninger eller nylagte komposittfyllinger føre til forandringer i herdeprosessen.

	EN ISO 4823	Produktfarge		Blandetid s
		Bas	Katalysator	
Putty <i>fast set</i>	Typ 0 kan eltes	grønn	lys grå	30
Putty <i>regular set</i>		grønn		30
Putty soft <i>fast set</i>		turkis		30
Putty soft <i>regular set</i>		turkis		30
Monophase Tube	Typ 2 middels	blå	lys grå	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		blå		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		lys blå		–
Medium Tube		gul	lys grå	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		gul		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		lys gul		–
Light Tube	Typ 3 myk	mørk grønn	lys grå	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		mørk grønn		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		grønn		–

*ved romtemperatur 23°C (73°F), 50% relativ fuktighet.

Høyere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlenger disse tidene.

Ekstraoral arbeidstid* 23°C (73°F) min:s	Intraoral arbeidstid 35°C (95°F) min:s	Minimum tid i munnen min:s	Tilbehør	
			Blandespisser	Intraorale spisser
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	grønn 66001989	hvit 65687514
2:00	1:00	3:30	grønn 66001989	hvit 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gul 66001988	gul 66000782
2:00	1:00	3:30	gul 66001988	gul 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	gul 66001988	gul 66000782
2:00	1:00	3:30	gul 66001988	gul 66000782

Bivirkninger:

Produktet eller en av dets komponenter kan i enkelte tilfeller forårsake allergiske reaksjoner. Ved mistanke om et slikt tilfelle, kan innholdsfortegnelse skaffes fra produsenten.

Modellfremstilling:

Avtrykket kan slås opp allerede 60 minutter etter at det er tatt ut av munnen. Det finnes ikke andre tidsbegrensninger. Avtrykket kan lagres stabilt over tid.

- Anbefalt modellmateriale:** Alle vanlige modellmaterialer kan brukes.
Vi anbefaler: Klasse III gips, MOLDANO®;
Klasse IV gips, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Galvanisering:** Avtrykkene kan forkobres og forsølves med galvanisering i vanlige bad.
- Desinfisering:** Avtrykkene kan behandles med en vannholdig natriumhypoklorittøsning (5,25 %, i inntil 10 minutter*) eller med andre desinfeksjonsløsninger som er egnet for silikon. Følg i denne forbindelse forskriftene om desinfeksjon og bruk fra de respektive produsentene.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Kontaktformidling:** Vi anbefaler å bruke vårt Universal Silicone Adhesive.
- Oppbevaringsbetingelser:** Må ikke lagres over 25°C (77°F).

Redaksjonen avsluttet: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Beskrivelse av bruks- / innpakkingsikoner

- | | |
|--|----------------------------------|
| A = Bruk kun masser med samme partinummer | E = Ekstraoral arbeidstid |
| B = Ikon "Det er mulig å bruke spesialprogrammet ved Dynamix® speed-blandingsenheten" | F = Intraoral arbeidstid |
| C = Blandingsforhold | G = Tid i munnen |
| D = Blandingstid | H = Statisk blandingstopp |
| | K = Intraoral tupp |

Elastomeerinen silikonipohjainen tarkkuusjäljennösmaa, A-silikoni

Kaikki Provil novo tuotteet sekoitetaan suhteessa 1 : 1 (Volyymi tai paino).

Käytännön vihjeitä

Provil novo tuotteet sopivat erinomaisesti yhdessä käytettäväksi. Erilaiset jäljennöstekniikka-vaihtoehdot mahdollistavat aina onnistuneen jäljennöksen. Emme suosittele niitä käytettäväksi muiden silikonien kanssa. Tarkasta vaurioitumattomuus silmämääräisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vaurioituneita tuotteita ei saa käyttää. Ei saa niellä eikä syödä. Mikäli jäljennösmaain nielemisen jälkeen esiintyy terveydellisiä ongelmia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Harvoissa tapauksissa voi esiintyä esim. suolitukos. Allergioita ei ole todettu, mutta tuotteen aiheuttamien allergioiden mahdollisuutta ei voi poissulkea. Ainoastaan hammaslääketieteellisen henkilökunnan käyttöön.

Tuubien korkit on kierrettävä huolellisesti paikalleen. Älä vaihda kansien, korkkien, lusikoiden oikeaa paikkaa. Kun käytät CD annostelupatruunoja ruiskuta vähän materiaalia ennen sekoituskärjen asettamista. Käytön jälkeen jätä sekoituskärki suojaksi. Seuraavan käytön alussa paina jälleen vähän materiaalia ja aseta uusi kärki.

Kaikissa A-silikoni aineissa voi ilmetä kovettumisongelmia jos ne joutuvat kontaktiin latex-käsineitten, ientaskulankojen nesteiden tai juuri tehtyjen yhdistelmämuovi täytteiden kanssa.

		EN ISO 4823	Tuoteväri		Sekoitusaika s
			Perusaine	Katalyytti	
Putty <i>fast set</i>	Tyyppi 0 muovattava		vihreä	vaalean harmaa	30
Putty <i>regular set</i>			vihreä		30
Putty soft <i>fast set</i>			turkoosi		30
Putty soft <i>regular set</i>			turkoosi		30
Monophase Tuubi	Tyyppi 2 keskivahva		sininen	vaalean harmaa	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>			sininen		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>			vaalean sininen		–
Medium Tuubi			keltainen	vaalean harmaa	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>			keltainen		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>			vaalean keltainen		–
Light Tuubi	Tyyppi 3 kevyt		tumman vihreä	vaalean harmaa	30
Light CD 2 <i>fast set</i>			tumman vihreä		–
Light CD 2 <i>regular set</i>			vihreä		–

*huoneenlämmössä 23°C (73°F), 50% suhteellinen kosteus.
Korkeampi lämpötila lyhentää, alempi pidentää näitä aikoja.

Työskentelyaika suun ulkopuolella* 23°C (73°F) min:s	Työskentelyaika suun sisäpuolella 35°C (95°F) min:s	Vähimmäisaika suussa min:s	Lisävarusteet	
			Sekoituskärjet	Intraoraalikärjet
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	vihreä 66001989	valkoinen 65687514
2:00	1:00	3:30	vihreä 66001989	valkoinen 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	keltainen 66001988	keltainen 66000782
2:00	1:00	3:30	keltainen 66001988	keltainen 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	keltainen 66001988	keltainen 66000782
2:00	1:00	3:30	keltainen 66001988	keltainen 66000782

Haittavaikutukset:

Tämä tuote tai sen ainesosat saattavat joissakin tapauksissa aiheuttaa allergisen reaktion. Tietoa ainesosista on saatavissa tarvittaessa valmistajalta.

Mallien valmistus:

Jäljennöksen valu voidaan suorittaa jo 60 minuutin kuluttua suusta oton jälkeen eikä muita aikarajoituksia ole. Jäljennös kestää pysyvän säilytyksen.

Suosittelun mallimateriaali:	Käyttää voidaan kaikkia tavallisia mallimateriaaleja. Suosittelemme: MOLDANO®-kipsi, luokka III; MOLDASTONE®/MOLDASYNT®-kipsi, luokka IV
Galvanointi:	Jäljennökset voidaan kuparoida ja hopeoida galvaanisesti kaikissa tavallisissa kylvyissä.
Desinfiointi:	Jäljennökset voidaan käsitellä natriumhypokloriittivesiliuoksella (5,25%, enintään 10 minuuttia*) tai muilla silikoneille sopivilla desinfiointiliuoksilla. Huomioi asianomaisen valmistajan laatimat desinfiointi-/käsittelymääräykset. * (DGZMK 3/93 V1.0)
Kiinnitys:	Suosittelimme Universal Silicone Adhesive -kiinnitysainemme käyttöä.
Säilytysolosuhteet:	Ei varastointia yli 25°C (77°F) lämpötilassa.

Painos: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Soveltuvien kuvakkeiden ja pakkauksen kuvakkeiden kuvaus

A = Käytä vain pastoja, joissa on sama eränumero	E = Työskentelyaika suun ulkopuolella
B = Kuvake "Dynamix® speed" -sekoitusyksikön erityisohjelman käyttö mahdollista"	F = Työskentelyaika suun sisäpuolella
C = Sekoitussuhde	G = Aika suussa
D = Sekoitusaika	H = Staattinen sekoituskärki
	K = Suunsisäinen kärki

Ελαστομερές υλικό αποτύπωσης ακριβείας με βάση σιλικόνη, πολυμερισμός προσθήκης

Όλα τα προϊόντα Provil novo είναι για αναλογία μίξης 1 : 1 (όγκος ή βάρος).

Πρακτικά Σημεία

Όλα τα είδη του Provil novo είναι τελευταίας τεχνολογίας συστήματα και αναδεικνύουν με τις ποικιλίες τους την πιθανότητα να συνδυασθούν ατομικά για όλες τις τεχνικές αποτύπωσης. Δε συνιστούμε τη χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα υλικά σιλικόνης. Πριν από την πρώτη χρήση ελέγχετε με οπτικό έλεγχο για πιθανές βλάβες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ελαττωματικά προϊόντα. Μην το καταπίνετε. Εάν μετά την κατάποση αποτυπωτικού υλικού έχετε ενοχλήσεις στην υγεία σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί π. χ. εντερική απόφραξη. Δεν έχουν αποδειχτεί αλλεργίες, παρόλα αυτά δεν μπορούν αποκλειστούν αλλεργίες από το προϊόν. Χρήση μόνο από οδοντιατρικό ειδικευμένο προσωπικό.

Τα σωληνάρια πρέπει να κλείνονται καλά μετά την κάθε χρήση. Μην ανακατεύετε καπάκια και κουτάλια ανάμιξης. Όταν χρησιμοποιείτε ψενέσεις, πιέστε έξω μερικό υλικό πριν κάνετε την ανάμιξη. Μετά τη χρήση κρατήστε τον αναμικτήρα σαν καπάκι στην ένεση. Αμέσως πριν την επόμενη χρήση, πιέστε έξω μερικό υλικό και το τοποθετήστε νέο αναμικτήρα.

Με όλα τα αποτυπωτικά υλικά αθροιστικού τύπου μπορεί να συμβούν αλλαγές στις συνθήκες επεξεργασίας μετά από επαφή με γάντια LATEX, διαλύματα ουλοαπώθησης ή με ρητίνες.

		Χρώμα παραγωγής		Χρόνος ανάμιξης δλ.
		EN ISO 4823	Βάση	
Putty <i>fast set</i>	Τύπος 0 εύπλαστο	πράσινο πράσινο τυρκουάζ τυρκουάζ	ανοιχτό γκρι	30
Putty <i>regular set</i>				30
Putty soft <i>fast set</i>				30
Putty soft <i>regular set</i>				30
Monophase <i>Tube</i>	Τύπος 2 μέτριας υφής	μπλέ μπλέ ανοιχτό μπλέ	ανοιχτό γκρι	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>				–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>				–
Medium <i>Tube</i>	Τύπος 3 ελαφριάς υφής	κίτρινο κίτρινο ανοιχτό κίτρινο	ανοιχτό γκρι	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>				–
Medium CD 2 <i>regular set</i>				–
Light <i>Tube</i>	Τύπος 3 ελαφριάς υφής	σκούρο πράσινο σκούρο πράσινο πράσινο	ανοιχτό γκρι	30
Light CD 2 <i>fast set</i>				–
Light CD 2 <i>regular set</i>				–

*σχετικά με θερμοκρασίες δωματίου 23°C (73°F), 50% σχετική υγρασία.

Μεγαλύτερες θερμοκρασίες μικραίνουν και μικρότερες θερμοκρασίες επιμηκύνουν αυτούς τους χρόνους.

Εξωστοματικός χρόνος εργασίας* 23°C (73°F)	Ενδοστοματικός χρόνος εργασίας 35°C (95°F)	Ελάχιστος χρόνος στο στόμα	Εξαρτήματα	
			Άκρα ανάμιξης	Ενδοστοματικά άκρα
λπ:δλ	λπ:δλ	λπ:δλ		
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	πράσινο 66001989	λευκό 65687514
2:00	1:00	3:30	πράσινο 66001989	λευκό 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	κίτρινο 66001988	κίτρινο 66000782
2:00	1:00	3:30	κίτρινο 66001988	κίτρινο 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	κίτρινο 66001988	κίτρινο 66000782
2:00	1:00	3:30	κίτρινο 66001988	κίτρινο 66000782

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Αυτό το προϊόν ή ένα από τα συστατικά του μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Σε περίπτωση υποψίας, πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι δυνατό να ληφθούν από τον κατασκευαστή.

Κατασκευή εκμαγείου:

Η έκχυση του εκμαγείου μπορεί να πραγματοποιηθεί περίπου 60 λεπτά μετά από την αφαίρεση από το στόμα, χωρίς άλλους περιορισμούς χρόνου. Το αποτύπωμα είναι μόνιμα σταθερό.

**Συνιστώμενο υλικό
κατασκευής εκμαγείου:**

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικά διαμόρφωσης που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Συνιστώνται: Γύψος τάξης III, MOLDANO®;

Γύψος τάξης IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Γαλβανισμός:

Τα αποτυπώματα μπορούν να επιμεταλλωθούν με χαλκό και άργυρο σε συνηθισμένα λουτρά ηλεκτρόλυσης.

Απολύμανση:

Τα αποτυπώματα μπορούν να απολυμανθούν με ένα υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (με περιεκτικότητα 5,25%, για έως 10 λεπτά*) ή με άλλα διαλύματα απολύμανσης, κατάλληλα για σιλικόνη. Τηρείτε τις σχετικές οδηγίες απολύμανσης/επεξεργασίας του εκάστοτε κατασκευαστή.

* (DGZMK 3/93 V1.0)

Συγκόλληση:

Συνιστάται η χρήση του γενικού συγκολλητικού παράγοντα σιλικόνης Universal Silicone Adhesive της εταιρείας μας.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Να μην αποθηκεύετε πάνω από 25°C (77°F).

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 2014-03

Description of applicational/packaging icons

Περιγραφή εικονιδίων εφαρμογής/ συσκευασίας

A = Χρησιμοποιείτε μόνο πάστες με τον ίδιο αριθμό παρτίδας

B = Εικονίδιο “Δυνατή η χρήση του ειδικού προγράμματος στη συσκευή ανάμιξης Dynamix® speed”

C = Αναλογία ανάμιξης

D = Χρόνος ανάμιξης

E = Εξωστοματικός χρόνος εργασίας

F = Ενδοστοματικός χρόνος εργασίας

G = Χρόνος στο στόμα

H = Στατικό ρύγχος ανάμιξης

K = Ενδοστοματικό ρύγχος

Elastomerní přesný otiskový materiál na bázi silikonu, dodatečně tvrzený

Všechny produkty Provil novo sortimentu jsou dávkovány v poměru 1 : 1 (množství nebo hmotnost).

Informace pro použití

Sortiment Provil novo je ideálně vzájemně sladěn y systém a nabízí vám se svými variantami možnosti individuální kombinace pro všechny otiskovací techniky. Nedoporučujeme použití v kombinaci s živými silikónovými materiály. Před prvním použitím zkontrolujte, zda výrobek nejeví viditelné známky poškození. Poškozené výrobky nesmějí být používány. Nepolykat a neužívat vnitřně. Vyskytnou-li se v případě spolknutí materiálu otisku zdravotní potíže, ihned kontaktujte lékaře. V ojedinělých případech může dojít např. k neprůchodnosti střev. Žádné alergie nebyly prokázány, přesto nelze alergie na výrobek vyloučit. Výrobek smí používat pouze kvalifikovaný zubařský personál.

Tuby / Dávky po použití pečlivě uzavřete. Nevzaměňujte uzávěr / víčko / dávkovací lžíci. Z kartuše před nasazením míchacího hrotu vytlačte trochu materiálu. Po použití nechte hrot jako uzávěr na kartuši. Bezprostředně před dalším použitím odstraňte hrot, vytlačte trochu materiálu a nasad'te nový hrot.

Při aditivních silikónových materiálech může při kontaktu s latexovými rukavicema, retrakčními roztoky nebo čerstvě položenými kompozitními výplněmi dojít k zmaření reakce.

		Barva produktu		Doba michani	
		EN ISO 4823	Základ		Katalyzátor
Putty <i>fast set</i>	Typ 0 tvarovatelný	EN ISO 4823	Želená	Světle šedá	30
Putty <i>regular set</i>			Želená		30
Putty soft <i>fast set</i>			Tyrkysová		30
Putty soft <i>regular set</i>			Tyrkysová		30
Monophase <i>Tuba</i>	Typ 2 středně zhuštěný	EN ISO 4823	Modrá	Světle šedá	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>			Modrá		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>			Bledě modrá		–
Medium <i>Tuba</i>	Typ 3 lehce zhuštěný	EN ISO 4823	Žlutá	Světle šedá	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>			Žlutá		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>			Světle žlutá		–
Light <i>Tuba</i>	Typ 3 lehce zhuštěný	EN ISO 4823	Tmavě zelená	Světle šedá	30
Light CD 2 <i>fast set</i>			Tmavě zelená		–
Light CD 2 <i>regular set</i>			Zelená		–

*vztahuje se na teplotu místnosti 23°C (73°F), 50% relativní vlhkost.
Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto doby.

Doba zpracování mimo dutinu ústní* 23°C (73°F)	Doba zpracování v dutině ústní 35°C (95°F)	Minimalní doba pobytu v ustech	Příslušenství	
			míchací koncovky	intraorální koncovky
min:s	min:s	min:s		
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	zelená 66001989	bilá 65687514
2:00	1:00	3:30	zelená 66001989	bilá 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	žlutá 66001988	žlutá 66000782
2:00	1:00	3:30	žlutá 66001988	žlutá 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	žlutá 66001988	žlutá 66000782
2:00	1:00	3:30	žlutá 66001988	žlutá 66000782

Nežadoucí účinky:

Tento výrobek nebo některá z jeho složek může v některých případech vyvolat alergickou reakci. V případě podezření může být informace o složení získána od výrobce.

Výroba modelu:

Otisk může být odlit 60 min. po vyjmutí z úst – žádné další omezení neexistuje. Otisk je stabilní při dlouhodobém skladování.

- Doporučený materiál modelu:** Lze použít všechny standardní materiály.
Doporučujeme:
Sádra třídy III, MOLDANO®;
Sádra třídy IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Elektrolytické pokovování:** Otisky lze elektrolyticky pokovovat mědí nebo stříbrem v konvenčních lázních.
- Dezinfekce:** Otisky lze ošetřit vodným roztokem chlornanu sodného (5,25% po dobu 10 minut*) nebo jinými desinfekčními roztoky vhodnými pro silikony. Při dezinfekci dodržujte pokyny pro dezinfekci/zpracování vydané příslušnými výrobci.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Adheze:** Doporučujeme použít naše universální silikonové adhezivum.
- Podmínky uchovávání:** Neskladovat při teplotách nad 25°C (77°F).

Datum revize: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Popis ikon pro aplikaci / na obalu

- | | |
|---|--|
| A = Používejte pouze pasty se stejným číslem šarže. | E = Doba zpracování mimo dutinu ústní |
| B = Ikona "Lze použít speciální program na mísicí jednotce Dynamix® speed" | F = Doba zpracování v dutině ústní |
| C = Poměr mísení | G = Doba v dutině ústní |
| D = Doba mísení | H = Špička pro statické mísení |
| | K = Intraorální špička |

Szilikonalapú elasztomer precíziós lenyomatanyag, többkomponensű

A Provil novo családkhoz tartozó összes anyag keverési aránya 1:1 (térfogat vagy súly alapján).

Használati utasítás a Provil novo-hoz (gyártó: Kulzer GmbH / Németország)

A Provil novo Sortiment egy ideális, egymáshoz kapcsolódó rendszer, amely variációs lehetőségeivel minden lenyomatvételi technikához megoldást kínál az igények szerint. Más szilikonbázisú anyagokkal történő együttes használatát nem ajánljuk. Első használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a sértetlenséget. A sérült termékeket tilos felhasználni. Tilos lenyelni és megenni. Ha a lenyomatanyag lenyelése után egészségügyi panaszok merülnek fel, azonnal forduljon orvoshoz! Ritka esetben pl. bélelzáródás fordulhat elő. Nem mutattak ki allergiát, de a termékkel szembeni allergiát mégsem lehet kizárni. Csak fogászati szakszemélyzet használhatja.

A tubusokat / dobozokat használat után minden esetben gondosan zárjuk be. A kupakokat / fedeleket / adagoló csatlakozásokat ne keverje össze. Mielőbb a kartusra felhelyezni a keverőcsőrt, nyomjon ki egy kevés anyagot. Használat után a keverőcsőrt hagyja a kartuson zárként. Közvetlenül használat előtt távolítsa el a keverőcsőrt nyomjon ki valamennyi anyagot és helyezze fel az új csőrt.

Az addíciós bázisú lenyomatanyagok esetében a latex kesztyűvel, retrakciós oldattal vagy a frissen behelyezett kompozit tömésekkel történő érintkezés megváltoztathatja a kötési tulajdonságokat.

	EN ISO 4823	Szín		Keverési idő mp
		Alap	Katalizátor	
Putty <i>fast set</i>	0. típus, gyúrható	zöld	világosszürke	30
Putty <i>regular set</i>		zöld		30
Putty soft <i>fast set</i>		türkiz		30
Putty soft <i>regular set</i>		türkiz		30
Monophase <i>Tub</i>	2. típus, közepes konzisztenciájú	kék	világosszürke	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		kék		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		világoskék		–
Medium <i>Tub</i>	konzisztenciájú	sárga	világosszürke	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		sárga		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		világossárga		–
Light <i>Tub</i>	3. típus, híg konzisztenciájú	sötétzöld	világosszürke	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		sötétzöld		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		zöld		–

*a megadott értékek 23°C (73°F) -os szobahőmérsékletnél, 50% rel. páratartalom mellett értendők. Magasabb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb pedig megnöveli ezeket az adatokat.

extraorális feldolgozási idő* 23°C (73°F) p:mp	intraorális feldolgozási idő 35°C (95°F) p:mp	Szájbantart. idő legalább p:mp	Adalékok	
			Keverőfej	Intraorálisfej
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	zöld 66001989	fehér 65687514
2:00	1:00	3:30	zöld 66001989	fehér 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	sárga 66001988	sárga 66000782
2:00	1:00	3:30	sárga 66001988	sárga 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	sárga 66001988	sárga 66000782
2:00	1:00	3:30	sárga 66001988	sárga 66000782

Mellekhatások:

Ez a termék vagy valamely összetevője egyedi esetekben allergiás reakciókat válthat ki. Amennyiben ez felmerül, a gyártótól lehet tájékoztatást kérni az összetevőkről.

Mintakészítés:

A lenyomat kiöntése 60 perccel a szájból történő kivétel után már elvégezhető. Nincs további időkorlátozás. A lenyomat hosszú távú tárolás során is stabil.

- Javasolt mintázóanyag:** Minden kereskedelmi forgalomban lévő mintázóanyag használható.
A következő anyagokat javasoljuk:
III. osztályú gipsz, MOLDANO®;
IV. osztályú gipsz, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
- Galvanizáció:** A lenyomatok a szokásos fürdőkben galvanizálhatóak rézzel és ezüsttel.
- Fertőtlenítés:** A lenyomatok vizes nátrium-hipoklorit oldatban (5,25%-os, max. 10 percig*) vagy egyéb, szilikonhoz használható fertőtlenítő oldatban kezelhetők. Kérjük, a kezelés során tartsa be a mindenkori gyártó fertőtlenítési/felhasználási előírásait.
* (DGZMK 3/93 V1.0)
- Ragasztóanyag:** Universal Silicone Adhesive ragasztóanyagunk használatát javasoljuk.
- Tárolási körülmények:** 25°C (77°F) alatt tárolja.

Kiadás datuma: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Az alkalmazott/csomagoláson szereplő szimbólumok leírása

- | | |
|---|---|
| A = csak az azonos tételszámmal rendelkező pasztákkal használja | E = extraorális feldolgozási idő |
| B = Szimbólum "A speciális program Dynamix® speed keverőegységben történő használat esetén lehetséges" | F = intraorális feldolgozási idő |
| C = keverési arány | G = intraorális kötési idő |
| D = keverési idő | H = statikus keverőcsőr |
| | K = intraorális toldalék |

Elastomēra nospiedumu materiāls uz silikona bāzes, uzlabots ar tīklveida struktūru
Visi Provil novo sortimenta produkti tiek fasēti attiecībā 1 : 1 (tilpums vai svars).

Lietošanas noteikumi

Provil novo Sortiment ir ideāli piemērota sistēma – ar dažādiem variantiem tā piedāvā jums iespēju visām nospiedumu metodēm izmantot individuālas kombinācijas. Mēs neiesakām lietot kombinācijā ar citiem silikona materiāliem. Pirms pirmās lietošanas lūdzu pārbaudīt ar vizuālās kontroles palīdzību, vai nav bojājumu. Nedrīkst izmantot bojātus izstrādājumus. Nerīt un nelietot iekšķīgi. Ja pēc veidojamā materiāla norīšanas rodas veselības traucējumi, nekavējoties griezties pie ārsta. Retos gadījumos var rasties, piem., zarnu aizsprostojums. Nav konstatēti alerģiju gadījumi, taču nevar izslēgt alerģijas rašanos pret izstrādājumu. Lietot drīkst tikai zobārstniecības personāls.

Tūbas / kārbas pēc lietošanas rūpīgi noslēgt. Nesajaukt kodus / vāciņus / dozēšanas karotes. Pirms maisīšanas kanīles lietošanas no iepakojuma izspiest nedaudz materiāla. Pēc lietošanas maisīšanas kanīli izmantot par iepakojuma vāciņu. Tieši pirms nākamās lietošanas maisīšanas kanīli izņemt, izspiest nedaudz materiāla un uzlikt jaunu maisīšanas kanīli.

Lietojot sagatavojamos silikona nospieduma materiālus, to saskare ar lateksa cimdium, retrakcijas šķīdumu vai svaigi ieliktiem kompozīta pildījumiem var izraisīt Nospieduma atdalīšanas procesa pārmaiņas.

		EN ISO 4823	Produkta krāsa		Sajaukšanas laiks
			Bāze	Katalizators	sek.
Putty <i>fast set</i>		0. tips veidojams	Zaļš	Gaiši pelēks	30
Putty <i>regular set</i>			Zaļš		30
Putty soft <i>fast set</i>			Tirkīza		30
Putty soft <i>regular set</i>			Tirkīza		30
Monophase <i>Tūbiņa</i>		2. tips vidējas konsistences	Zila	Gaiši pelēks	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>			Zila		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>			Gaiši zila		–
Medium <i>Tūbiņa</i>			Dzeltena	Gaiši pelēks	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>			Dzeltena		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>			Gaiši dzeltena		–
Light <i>Tūbiņa</i>		3. tips vieglas konsistences	Tumši zaļš	Gaiši pelēks	30
Light CD 2 <i>fast set</i>			Tumši zaļš		–
Light CD 2 <i>regular set</i>			Zaļš		–

*telpas temperatūra 23°C (73°F), relat. mitrums 50%.

Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka temperatūra pagarina uzrādīto laiku.

Ekstraorālās iedarbības ilgums* 23°C (73°F) min.:sek.	Intraorālās iedarbības ilgums 35°C (95°F) min.:sek.	Minimālais laiks mutē min.:sek.	Piederumi	
			Maisīšanas uzgaļi	Intraorālie uzgaļi
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	zaļš 66001989	balts 65687514
2:00	1:00	3:30	zaļš 66001989	balts 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	dzeltēna 66001988	dzeltēna 66000782
2:00	1:00	3:30	dzeltēna 66001988	dzeltēna 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	dzeltēna 66001988	dzeltēna 66000782
2:00	1:00	3:30	dzeltēna 66001988	dzeltēna 66000782

Blakusparādības:

Atsevišķos gadījumos šis izstrādājums vai kāda no tā sastāvdaļām var izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja ir aizdomas, ka pastāv šāda iespējamība, no ražotāja iespējams saņemt informāciju par izstrādājuma sastāvdaļām.

Modeļa izveide:

Nospiedumu var atliet 60 min. pēc nospieduma izņemšanas no mutes – nepastāv citi laika ierobežojumi. Nospiedums ir stabils to uzglabājot ilgstoši.

Ieteicamais modeļa materiāls:

Var izmantot visus standarta modeļu materiālus.
Ieteicamākie: III kategorijas ģipsis, MOLDANO®;
IV kategorijas ģipsis, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galvanizācija:

Nospiedumus var galvanizēt ar varu un sudrabu standarta vannās.

Dezinfekcija:

Nospiedumus var apstrādāt ar hipohlorīta ūdens šķīdumu (5,25%, ne ilgāk kā 10 minūtes*) vai ar citiem dezinfekcijas šķīdumiem, ko var izmantot silikoniem. Veicot dezinfekciju, lūdzu, ievērojiet attiecīgā ražotāja sniegtās dezinfekcijas/apstrādes instrukcijas.

**(DGZMK 3/93 V1.0)*

Adhēzija:

Ieteicams izmantot universālo silikona adhezīvu.

Uzglabāšanas nosacījumi:

Neuzglabāiet temperatūrās, kas augstākas nekā 25°C (77°F).

Teksta pārskatīšanas datums: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Lietošanas / iesaiņojuma ikonu apraksts

A = Izmantot tikai pastas ar vienādu sērijas numuru

B = Ikona „Iespējama īpašās programmas lietošana Dynamix® speed maisīšanas iekārtā“

C = Maisīšanas attiecība

D = Maisīšanas ilgums

E = Ekstraorālās iedarbības ilgums

F = Intraorālās iedarbības ilgums

G = Atrašanās mutē ilgums

H = Statiskais maisīšanas uzgalis

K = Intraorālais uzgalis

Elastomerinė, silikoninė, tiksli A tipo atspaudinė medžiaga

Visi Provil novo produktai dozuojami santykiu 1 : 1 (tūris arba svoris).

Naudojimo nurodymai

Provil novo Sortiment yra idealiai suderinta sistema, suteikianti Jums galimybę jos atskirus variantus naudoti individualiai su bet kuria atspaudų ėmimo technika. Mes rekomenduojame nenaudoti produkto kartu su kitomis silikoninėmis medžiagomis. Prieš naudodami pirmą kartą patikrinkite, ar produktas nepažeistas. Pažeistų produktų naudoti negalima. Neryti ir nevertoti. Jei nurijus formavimo medžiagos kyla sveikatos sutrikimų, reikia nedelsiant kreiptis į daktarą. Kai kuriais atvejais gali pasireikšti, pvz., žarnyno nepraeinamumas. Nėra įrodymų, kad produktas gali sukelti alergiją, tačiau alergija galima. Naudoti gali tik dantų gydymo specialistai.

Po naudojimo tūbelę ar indelį gerai uždarykite. Nesupainiokite kamštelių, dangtelių ar dozavimo šaukštelių. Prieš uždėdami maišymo antgalį, iš kasetės išspauskite šiek tiek medžiagos. Po naudojimo maišymo antgalį palikite ant kasetės kaip kamštelį. Prieš pat kitą naudojimą seną maišymo antgalį nuimkite, išspauskite šiek tiek medžiagos ir uždėkite naują maišymo antgalį.

Naudojant adityvines silikonines atspaudų medžiagas, joms liečiantis su lateksinėmis pirštinėmis, refrakcijos tirpalais ar ką tik uždėtomis kompozicinėmis plombomis, gali pakisti medžiagos surišimo procesas.

		EN ISO 4823	Produkto spalva		Sumaišymo laikas s
			Pagrindas	Katalizatorius	
Putty <i>fast set</i>		0 tipas liejama	Žalia	Šviesiai pilka	30
Putty <i>regular set</i>			Žalia		30
Putty soft <i>fast set</i>			Turkis		30
Putty soft <i>regular set</i>			Turkis		30
Monophase <i>Tuba</i>		2 tipas vidutinės konsistencijos	Mėlyna	Šviesiai pilka	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>			Mėlyna		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>			Šviesiai mėlyna		–
Medium <i>Tuba</i>			Geltona	Šviesiai pilka	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>			Geltona		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>			Šviesiai geltona		–
Light <i>Tuba</i>		3 tipas skystos konsistencijos	Tamsiai žalia	Šviesiai pilka	30
Light CD 2 <i>fast set</i>			Tamsiai žalia		–
Light CD 2 <i>regular set</i>			Žalia		–

*jei oro temperatūra 23°C (73°F), 50% santykinis drėgnumas.

Dėl aukštos temperatūros šie laikai trumpėja, dėl žemos ilgėja.

Ekstraoralinis darbo laikas* 23°C (73°F)	Intraoralinis darbo laikas 35°C (95°F)	Mažiausias laikymo burnoje laikas	Reikmenys	
			Maišymo antgaliai	Intraoraliniai antgaliai
min.:sek.	min.:sek.	min.:sek.		
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	žalia 66001989	balta 65687514
2:00	1:00	3:30	žalia 66001989	balta 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	geltona 66001988	geltona 66000782
2:00	1:00	3:30	geltona 66001988	geltona 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	geltona 66001988	geltona 66000782
2:00	1:00	3:30	geltona 66001988	geltona 66000782

Pašaliniai poveikiai:

Šis gaminy s ar kuri nors iš jo sudedamųjų dalių tam tikrais atvejais gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Kilus įtarimams, informaciją apie sudedamąsias dalis galima gauti iš gamintojo.

Modelių gamyba:

Atspaudu padarymas gali trukti apie 60 minučių po išėmimo iš burnos – jei nėra kitų laiko apribojimų. Atspaudas yra stabilus ilgalaikiam laikymui.

Rekomenduojama modelio medžiaga:	Gali būti naudojami visos standartinės modelių medžiagos. Mes rekomenduojame: III klasės gipsas, MOLDANO®; IV klasės gipsas, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Elektrodengimas:	Atspaudai gali būti elektrodengiami su variu ir sidabru įprastose vonelėse.
Dezinfekcija:	Atspaudai gali būti paveikiami vandeniniu natrio hipochlorito tirpalu (5,25%, 10 minučių*) arba su kitu dezinfekciniu tirpalu, tinkamu silikonui. Tai atliekant prašome vadovautis atitinkamo gamintojo dezinfekcijos/apdorojimo instrukcijomis. * (DGZMK 3/93 V1.0)
Surišimas:	Mes rekomenduojame naudoti mūsų universalų silikoninį surišiklį.
Laikymo sąlygos:	Nelaikyti temperatūroje aukštesnėje nei 25°C (77°F).

Peržiūros data: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Naudojimo nurodymų / pakuočių simbolių aprašymas

A = Naudoti tik tos pačios partijos numeriu pažymėtą pastą	E = Ekstraoralinis darbo laikas
B = Symbolis „Galima naudoti Dynamix® speed maišymo įtaiso specialią programą“	F = Intraoralinis darbo laikas
C = Maišymo santykis	G = Laikas burnoje
D = Maišymo laikas	H = Statinis maišymo antgalis
	K = Intraoralinis antgalis

Elastomerowa precyzyjna masa wyciskowa na bazie silikonu, sieciowana addycyjnie

Wszystkie masy systemu Provil novo mieszają się w stosunku 1 : 1 (wagowym i objętościowym).

Wskazówki dotyczące stosowania

System Provil novo to idealnie dobrany system, który dzięki mnogości swoich komponentów umożliwia indywidualne zastosowanie we wszystkich technikach wyciskowych. Nie zalecamy stosowania z innymi silikonowymi masami wyciskowymi. Przed pierwszym użyciem należy skontrolować, czy są widoczne uszkodzenia. Nie wolno stosować uszkodzonych produktów. Nie wkładać do ust i nie połykać. Jeżeli po połknięciu wystąpią dolegliwości zdrowotne, natychmiast skontaktować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach może dojść np. do niedrożności jelit. Nie wykazano występowania alergii, jednak nie można wykluczyć alergii na produkt. Do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Opakowania po użyciu dokładnie zamknąć. Nie zamieniać nakrętek / pokrywek / tyżeczek. W przypadku stosowania dozownika CD należy wycisnąć trochę masy przed nasadzeniem końcówki mieszającej CD. Po dokonaniu wycisku należy końcówkę mieszającą CD pozostawić na dozowniku CD jako zamknięcie. Przed następnym wyciskiem usunąć końcówkę mieszającą CD i ponownie wycisnąć trochę masy przed nasadzeniem nowej końcówki mieszającej CD.

W przypadku silikonowych mas wyciskowych o addycyjnym sposobie wiązania kontakt z rękawiczkami lateksowymi, płynem retrakcyjnym lub świeżo założonym wypełnieniem kompozytowym może zakłócić proces wiązania tych mas.

		Kolor produktu		Czas mieszania	
		EN ISO 4823	Baza		Katalizator
Putty <i>fast set</i>		Typ 0 do ugniatania	zielony	jasnoszary	30
Putty <i>regular set</i>			zielony		30
Putty soft <i>fast set</i>			turkusowy		30
Putty soft <i>regular set</i>			turkusowy		30
Monophase <i>Tuba</i>		Typ 2 o średniej gęstości	niebieski	jasnoszary	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>			niebieski		-
Monophase CD 2 <i>regular set</i>			jasnoniebieski		-
Medium <i>Tuba</i>			żółty	jasnoszary	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>			żółty		-
Medium CD 2 <i>regular set</i>			jasnożółty		-
Light <i>Tuba</i>		Typ 3 o niskiej gęstości	ciemnozielony	jasnoszary	30
Light CD 2 <i>fast set</i>			ciemnozielony		-
Light CD 2 <i>regular set</i>			zielony		-

*przy temperaturze 23°C (73°F), 50% wilgotności.

Wyższa temperatura skarca, a niższa wydłuża czas wiązania.

Czas pracy poza jamą ustną* 23°C (73°F)	Czas pracy w jamie ustnej 35°C (95°F)	Czas pobierania wycisku	Akcesoria	
			Końcówki do mieszania	Końcówki doustne
min:s	min:s	min:s		
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	zielony 66001989	biały 65687514
2:00	1:00	3:30	zielony 66001989	biały 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	żółty 66001988	żółty 66000782
2:00	1:00	3:30	żółty 66001988	żółty 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	żółty 66001988	żółty 66000782
2:00	1:00	3:30	żółty 66001988	żółty 66000782

Działania niepożądane:

Ten produkt lub jeden z jego składników może w szczególnych przypadkach powodować reakcje alergiczne. W razie wątpliwości, informacje o składnikach można otrzymać od producenta.

Odewanie modeli:

Odlanie wycisku można wykonać już po 60 min. po wyjęciu z jamy ustnej, brak innych ograniczeń czasowych. Wycisk jest trwale stabilny na przechowywanie.

Zalecany materiał modelowy:

Możliwe zastosowanie wszystkich dostępnych w handlu materiałów modelowych.

Polecamy: Gips klasy III, MOLDANO®;

Gips klasy IV, MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Galwanizacja:

Wyciski można miedziować i posrebrzać galwanicznie w zwykłych kąpielach.

Dezynfekcja:

Wyciski można dezynfekować wodnym roztworem podchlorynu sodu (5,25-procentowy, do 10 minut*) lub innym roztworem dezynfekcyjnym odpowiednim dla silikonu. Należy przy tym przestrzegać czasów dezynfekcji / przetwarzania podanych przez producenta. * (DGZMK 3/93 V1.0)

Przyleganie do powierzchni

łyżek wyciskowych:

Zalecamy stosowanie naszego kleju Universal Silicone Adhesive.

Warunki przechowywania: Nie przechowywać w temp. powyżej 25°C (77°F).

Wersja: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Opis ikon dotyczących stosowania / opakowania

A = Stosować tylko pasty o tym samym numerze serii

B = Ikona „Możliwość stosowania programu specjalnego w urządzeniu mieszającym Dynamix® speed”

C = Współczynnik mieszania

D = Czas mieszania

E = Czas pracy poza jamą ustną

F = Czas pracy w jamie ustnej

G = Czas w jamie ustnej

H = Statyczna końcówka mieszająca

K = Końcówka do bezpośredniej aplikacji

Прецизионный слепочный эластомерный материал на основе силикона с присоединительной полимеризацией
Для всех изделий линии Provil novo следует использовать дозировочное соотношение 1 : 1 (по объему или по массе).

Практические советы

Линия Provil novo представляет собой набор материалов с различной консистенцией, которые можно индивидуально комбинировать для всех методик создания слепков. Не рекомендуем применять в комбинации с какими-либо иными силиконовыми слепочными материалами. Перед первым использованием провести визуальный контроль на наличие повреждений. Запрещается использовать поврежденные продукты. Не глотать и не принимать внутрь. Если после проглатывания формовочного материала возникают жалобы на здоровье, незамедлительно обратиться к врачу. В редких случаях может возникать непроходимость кишечника. При определенных обстоятельствах этот продукт или один из его компонентов могут вызывать аллергические реакции. Если есть подозрение, можно получить информацию об ингредиентах, обратившись к изготовителю. Только для профессионального использования в стоматологии.

Тубы и флаконы следует тщательно герметично закрывать после применения. Не меняйте местами крышки, колпачки или ложки. При использовании картриджей выдавите немного материала до установки смешивающей насадки. После использования оставляйте смешивающую насадку на картридже в качестве герметизирующей заслонки. Перед следующим использованием снимите заблокированную насадку. Выдавите немного материала, а затем установите новую смешивающую насадку.

Как и у всех силиконовых слепочных материалов с присоединительной полимеризацией, возможно возникновение ингибирующих реакций с пастойкатализатором при контакте с резиновыми перчатками, ретракционными растворами и недавно установленными композитными пломбами. Поэтому обязательно выполните промывание ротовой полости пациента (в частности, области препаровки и края десны) и высушите перед началом формирования слепка.

	EN ISO 4823	Цвет изделия		Время смешивания с
		База	Катализатор	
Putty <i>fast set</i>	Type 0 putty	зеленый	светлосерый	30
Putty <i>regular set</i>		зеленый		30
Putty soft <i>fast set</i>		бирюзовый		30
Putty soft <i>regular set</i>		бирюзовый		30
Monophase <i>Tube</i>	Type 2 medium bodied	синий	светлосерый	30
Monophase CD 2 <i>fast set</i>		синий		–
Monophase CD 2 <i>regular set</i>		светло-синий		–
Medium <i>Tube</i>	Type 2 medium bodied	желтый	светлосерый	30
Medium CD 2 <i>fast set</i>		желтый		–
Medium CD 2 <i>regular set</i>		светло-желтый		–
Light <i>Tube</i>	Type 3 light bodied	темно-зеленый	светлосерый	30
Light CD 2 <i>fast set</i>		темно-зеленый		–
Light CD 2 <i>regular set</i>		зеленый		–

*Измерения проводились при комнатной температуре 23°C (73°F) и 50% относительной влажности воздуха. Время обработки уменьшается при более высоких температурах и увеличивается при низких температурах.

Время обработки вне полости рта* 23°C (73°F) мин:с	Время обработки в полости рта 35°C (95°F) мин:с	Мин. время пребывания во рту мин:с	Аксессуары	
			Mixing Tips	Intraoral Tips
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
1:30	–	2:30	–	–
2:00	–	3:30	–	–
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	зеленый 66001989	белый 65687514
2:00	1:00	3:30	зеленый 66001989	белый 65687514
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	желтый 66001988	желтый 66000782
2:00	1:00	3:30	желтый 66001988	желтый 66000782
2:30	1:00	3:30	–	–
1:30	0:40	2:30	желтый 66001988	желтый 66000782
2:00	1:00	3:30	желтый 66001988	желтый 66000782

Побочные эффекты:

При определенных обстоятельствах этот продукт или один из его компонентов могут вызывать аллергические реакции. Если есть подозрение, можно получить информацию об ингредиентах, обратившись к изготовителю.

Изготовление модели:

Отливку можно выполнять через 1 час после извлечения слепка из полости рта. Других ограничений нет. Застывший слепок обладает гарантированной долгосрочной устойчивостью.

Рекомендуемые моделировочные материалы:	Изделия совместимы со всеми доступными в продаже моделировочными материалами. Рекомендуем: гипс класса III, например MOLDANO®; Гипс класса IV, например MOLDASTONE®/MOLDASYNT®
Гальванизация:	Слепки можно покрывать слоем меди или серебра в классических гальванических ванночках.
Дезинфекция:	Слепки обычно следует обрабатывать путем погружения на 10 минут* в 5,25% раствор гипохлорита натрия. Другие дезинфицирующие растворы, предназначенные специально для силикона, следует применять согласно указаниям изготовителя соответствующего изделия. * (DGZMK 3/93 V1.0)
Адгезив для слепочных ложек:	Мы рекомендуем использовать изделие «Universal Adhesive» производства Kulzer.
Условия хранения:	Хранить при температуре не выше 25°C (77°F).

Дата редакции документа: 2014-03

Description of applicational / packaging icons

Описание пиктограмм на продукте и упаковке

A = Использовать только пасты с одним и тем же № партии.	E = Время обработки вне полости рта
B = Пиктограмма «Возможно использование специальной программы на смесителе Dynamix® speed»	F = Время обработки в полости рта
C = Соотношение для смешивания	G = Время в полости рта
D = Время смешивания	H = Фиксированный смесительный наконечник
	K = Внутриротовой наконечник



Manufacturer:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)

Made in Romania

Distributed in USA / Canada exclusively by:
Kulzer, LLC
4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785

Caution: Federal law restricts this device to
sale by or on the order of a dentist.



66056456/11